


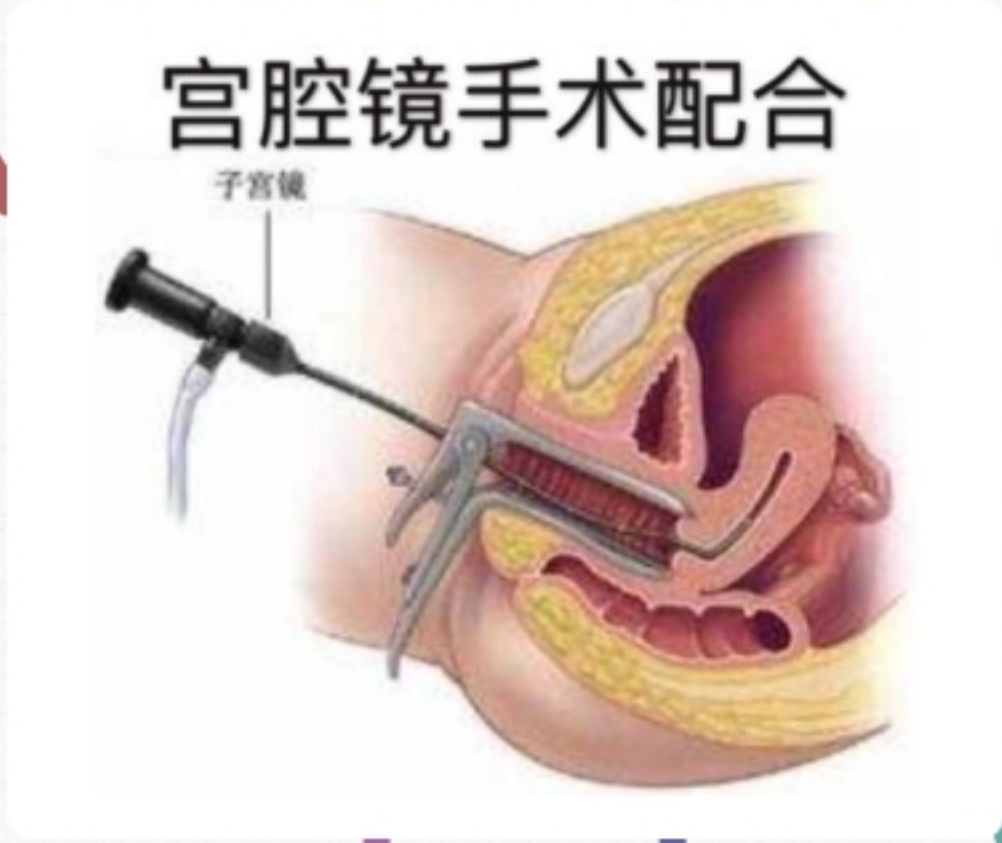

手术时机

- 1、子宫内膜处于增生早期，轻薄不易出血
- 2、粘液分泌少，病变易暴露
- 月经干净后3~7日

适应症

- 1、不孕症：找到输卵管开口，行通畅实验
- 2、子宫异常出血：内膜癌、息肉、肌瘤、功能失调性出血
- 3、了解宫腔情况：粘连
- 4、宫内节育器并发症：嵌顿、变形、移位
- 5、宫腔异物：不全流产残留物

禁忌症

- 1、妊娠情况：早期宫内宫外孕
- 2、阴道流血：中等量以上阴道流血
- 3、手术史：近期内刮宫者
- 4、炎症
- 5、宫颈癌患者
- 6、宫颈瘢痕、宫颈裂伤或松弛

并发症

- 1、空气栓塞 (VAE)
 - 10ML空气即可引起
 - 300ML即可死亡
- 2、子宫穿孔
- 3、子宫出血
 - 纱布压迫止血
 - 机械压迫止血：插入尿管，球囊注水10~30ML
- 4、水中毒 (稀释性低钠血症)
 - 单极时注入非电解质溶液更易发生

术中关注点

- 1、准确记录出入量：防止水中毒
- 2、排空进水管内的空气，防止空气栓塞
- 3、正确调节膨宫压力，控制宫内压力 (80~110mmhg, <=130mmhg)
- 4、正确安置体位，防止体位伤
- 5、加强无菌技术操作，防止感染
- 6、注意术中保暖，防止低体温的发生
 - 冲洗液加温
 - 室温调节：21℃-25℃
 - 给病人保温：棉被、加温毯
- 7、防止异物残留：三次共同清点、操作时随时观察器械完整性
- 8、正确保管标本，防止标本遗失和出现差错
- 9、适时给病人约束，防止病人坠床、跌倒
- 10、保持床单平整干燥，防止压疮
- 11、正确粘贴负极板，防止电灼伤
- 12、加强术中监护
 - 呼吸末CO2压力
 - 血氧饱和度的检测

手术体位

- 1、平卧位：患者平卧于可分腿的手术床中央，穿上腿套，双下肢分开80~90°，臀部超出手术床边缘5cm
- 2、膀胱结石位：患者平卧于手术床中央，腿架高度为患者大腿长度的2/3，保持足尖、膝关节和对侧肩在一条直线上，两腿夹角最大不超过90°

手术类别

- 1、检查术
- 2、肌瘤切除术
- 3、息肉切除术
- 4、内膜切除术
 - 电凝滚
 - 针状电极
- 5、分粘术
 - 异物钳
- 6、取环术
- 7、纵膈切除术
 - 宫腔纵膈 (针状电极+电切线)
- 8、子宫切口憩室切除术
- 9、胎盘残留切除术

用物准备

1、物资

无菌手套

脑科薄膜

无菌腔镜套

阴道包

衣服

★一次性用物

★布类

★膨宫液

2、器械

作为单极宫腔镜器械的膨宫介质

作为双极宫腔镜器械的膨宫介质

甘肨醇、糖水

生理盐水

3、仪器设备

显示器

摄像系统

摄像头

冷光源机

影像工作站

高频电刀

膨宫泵

镜子、宫腔镜操作器械

电切镜

内鞘套

电切环

切开环

外鞘套及闭孔器

套环

电凝滚

科室：住院部手术室

制作者：杨旭 杨域宁

指导老师：袁琦 陈理 李济宏